

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Deliberazione n. 260 del 17.03.2020

Struttura proponente: UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori


Oggetto: Servizio Lavanolo CIG derivato 8051433CB0 – Modifica contrattuale per servizi supplementari ex 106, comma 1 lett. b) del Codice (Esecutore: RTI Servizi Sanitari Integrati S.r.l. / Lavanderia D'Alessio S.r.l.).

A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

- l'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;
- i costi/ricavi, così come riportati nel dispositivo, sono correttamente valorizzati in relazione agli effetti derivanti dal presente atto OVVERO gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- gli oneri di cui al presente atto sono non sono ricompresi nel *budget* di assegnazione

L'estensore: (Dr. Giorgia Levante)

Firma 

Il Responsabile del procedimento (Dr.ssa Carla Cianciullo)

Firma 

Il Direttore (Dr.ssa Carla Cianciullo)

Firma 

A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:

- ATTESTA che i costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati OVVERO CONFERMA che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- CONFERMA: che gli oneri di cui al presente atto sono non sono ricompresi nel *budget* di assegnazione


Il Direttore: Dr. Stefano Piccari

N. cronologico: 299 /2020

Parere Direttore Amministrativo

Favorevole Contrario

Dr. A. Fiore

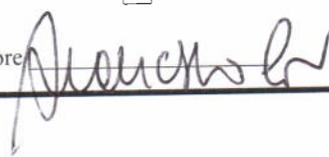

Parere Direttore Sanitario f.f.

Favorevole Contrario

Prof. A. Magrini



Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00167 del 1° luglio 2019 nonché con deliberazione del Consiglio di amministrazione assunta in data 1° luglio 2019, la dr.ssa Tiziana Frittelli è stata nominata Commissario straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e dell’Azienda ospedaliera universitaria PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTA la Circolare prot. n. 0007972 del 25/03/2016, in materia di redazione degli atti deliberativi alla quale si fa integrale rinvio;

PREMESSO CHE:

- la Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio con Determinazione n. G16423 del 28/12/2016 ha indetto la “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio” suddivisa in 8 Lotti e ne ha disposto l’aggiudicazione con successiva Determinazione n. G12153 del 01/10/2018, trattandosi di servizio rientrante nelle categorie merceologiche soggette a gara centralizzata già ai sensi del DPCM 24/12/2015, recentemente aggiornato da successivo DPCM 11/07/2018;
- per il Lotto 4 della suddetta procedura – comprensivo del fabbisogno del Policlinico Tor Vergata e dell’ASL Roma 6 (CIG di gara 692224621C) - è risultato aggiudicatario il raggruppamento costituito dagli operatori economici Servizi Sanitari Integrati S.r.l. (mandataria) e Lavanderia D’Alessio S.r.l. (mandante);

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

- con Deliberazione n. 832 del 04/10/2019, il PTV ha recepito l’esito dell’aggiudicazione della citata procedura centralizzata regionale per le quantità e i servizi ricompresi nel progetto originario come da sopra citata aggiudicazione disposta con Determinazione n. G12153 del 01/10/2018, e acquisito il seguente CIG derivato: 8051433CB0;
- in data 18/11/2019 è stata emesso Ordinativo di fornitura (Contratto) della durata di 60 mesi, decorrenti dal 19/11/2019 e con scadenza al 18/11/2024 per un importo complessivo pari a € 4.228.403,55 IVA esclusa;
- il suddetto ordinativo ricomprende i seguenti servizi (noleggio e lavaggio teleria piana, divise e materassi) per le relative quantità annuali:

SERVIZIO	Q.tità indicative per la durata presunta OdF
Giornata di degenza ordinaria (comprensivo di noleggio e lavaggio di teleria piana, copri letto, materassi, cuscini)	752.775
Giornata di degenza Day Hospital e Day Surgery (comprensivo di noleggio e lavaggio di teleria piana, copri letto, cuscini)	124.055
Accessi al pronto Soccorso (comprensivo di noleggio e lavaggio di teleria piana)	261.560
Operatori addetti vestiti al giorno	14.155

Fondazione PTV

POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

PREMESSO, INFINE, CHE con DCA n. U00255 del 04/07/2019 la Regione Lazio ha individuato i Sistemi antidecubito quale categoria oggetto di gare regionali per l'anno 2020, pertanto il PTV non ha proceduto all'indizione di relativa procedura autonoma;

TENUTO CONTO CHE il Direttore dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Responsabile del procedimento, nominati con la citata Deliberazione di recepimento n. 832/2019 hanno individuato, come da relazione allegata (Allegato 1), alcuni servizi indispensabili per l'erogazione da parte del PTV delle prestazioni sanitarie in sicurezza, omogenei con le attività di lavanolo già in recepimento dell'esito della gara regionale;

DATO ATTO CHE tali servizi, di seguito elencati, non erano inclusi nell'appalto iniziale elaborato dalla Regione Lazio:

SERVIZI	DRIVER CORRISPETTIVO	QUANTITÀ
Noleggio e lavaggio teleria piana quartiere operatorio	canone mensile noleggio e lavaggio biancheria piana	n. 100 lenzuola n. 10 federe n. 60 traverse cotone n. 10 copriletto
Cinte contenzione di proprietà del ptv	prezzo unitario per lavaggio	
Camici piombati di proprietà del ptv	prezzo unitario per lavaggio	
Teli sollevamento pazienti di proprietà del ptv	prezzo unitario per lavaggio	
Lavaggio tende di proprietà del ptv	canone annuo comprensivo di 2 lavaggi/anno + smontaggio e rimontaggio tende (circa 4.412mq)	mq 4.412 (complessivi tendaggi)
Materiale ignifugo canone noleggio biancheria piana	prezzo unitario per giornata di degenza	gg degenza anno 2019 n. 5840
Materiale ignifugo canone <u>noleggio</u> casacca e pantalone pigiama per SPDC	prezzo unitario per noleggio	circa 30 pigiami (per 16 p.l.)
Materiale ignifugo canone <u>lavaggio</u> casacca e pantalone pigiama per SPDC	prezzo unitario per pezzo lavato	circa 1.550 lavaggi anno
Noleggio materassi antidecubito	prezzo unitario giorno/materasso	n. 100 materassi

DATO ATTO CHE l'affidamento allo stesso esecutore del servizio di lavanolo consente di realizzare evidenti sinergie derivanti dalla possibilità di utilizzare il medesimo personale dell'aggiudicatario già presente quotidianamente presso il PTV per le attività di consegna e ritiro della biancheria, di unificare gli spazi per lo stoccaggio già assegnati all'esecutore del servizio di lavanolo nonché di economicizzare il processo amministrativo;

ACQUISITA dall'Operatore l'offerta economica e le relative condizioni di fornitura (Allegato 2);

VALUTATI CONGRUI i prezzi offerti di seguito riportati come da nota del Direttore dell'esecuzione del contratto e del Responsabile del procedimento (Allegato 3);

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Servizi	Driver Corrispettivo	Prezzo unitario	Totale annuo Iva esclusa	Totale affidamento Iva esclusa
Noleggio e lavaggio teleria piana quartiere operatorio	canone mensile noleggio e lavaggio biancheria piana	€ 1.221,00	€ 14.652,00	€ 68.376,00
Cinte contenzione di proprietà del PTV	prezzo unitario per lavaggio	€ 0,30	€ 30,00	€ 140,00
Camici piombati di proprietà del PTV	prezzo unitario per lavaggio	€ 4,00	€ 120,00	€ 600,00
Teli sollevamento pazienti di proprietà del PTV	prezzo unitario per lavaggio	€ 0,30	€ 30,00	€ 140,00
Lavaggio tende di proprietà del PTV	canone annuo comprensivo di 2 lavaggi/anno + smontaggio e rimontaggio tende (circa 4.412mq)	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 155.000,00
Materiale ignifugo canone noleggio biancheria piana	prezzo unitario per giornata di degenza	€ 6,10	€ 35.624,00	€ 166.245,33
Materiale ignifugo canone <u>noleggio</u> casacca e pantalone pigiama per SPDC	prezzo unitario per noleggio	€ 1,10	€ 6.424,00	€ 29.978,67
Materiale ignifugo canone <u>lavaggio</u> casacca e pantalone pigiama per SPDC	prezzo unitario per pezzo lavato	€ 1,10	€ 14.016,00	€ 65.408,00
Noleggio materassi antidecubito	prezzo unitario giorno/materasso	€ 2,85	€ 104.025,00	€ 476.781,25
TOTALE			€ 205.921,00	€ 962.669,25

TENUTO CONTO CHE tutti i servizi sopra elencati saranno erogati a decorrere dal 01/04/2020 fatta eccezione per il servizio di noleggio dei materassi antidecubito il cui avvio è stabilito dal 01/05/2020, e termineranno a scadenza dell'appalto iniziale fissata al 18/11/2024;

RILEVATA PERTANTO, per quanto sopra esposto, l'opportunità di avvalersi, ai fini dell'esecuzione dei suddetti servizi, del RTI costituito dagli operatori economici Servizi Sanitari Integrati S.r.l. (mandataria) e Lavanderia D'Alessio S.r.l. (mandante), contraente originale dell'attuale appalto del Servizio lavanolo;

RICHIAMATO l'art. 106, comma 1 lett. b) del Codice il quale disciplina la modifica del contratto per servizi supplementari;

RICHIATO, ALTRESÌ, l'art. 106, comma 7 del Codice il quale prevede che, per i casi di cui al citato articolo 106, comma 1 lett. b) del Codice, "il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale";

TENUTO CONTO CHE il valore del contratto iniziale è pari a € 4.228.403,55 IVA esclusa, come risultante dalla citata Deliberazione n. 832/2019;

TENUTO CONTO, ALTRESÌ, CHE l'importo complessivo dei servizi supplementari oggetto della presente Deliberazione risulta pari a € 962.669,25 IVA esclusa, corrispondente al 23 per cento del valore del contratto iniziale;

VERIFICATO CHE per quanto riguarda la definizione degli oneri derivanti dalla modifica in parola, per il periodo contrattuale dal 01/04/2020 al 18/11/2024, gli stessi, pari a € 962.669,25 IVA esclusa e, dunque, pari a € 1.174.456,49 IVA inclusa, graveranno sui seguenti sottoconti per gli esercizi di seguito indicati:

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Sottoconto	2020	2021	2022	2023	2024	totale
502020101000 Lavanderia	102.726,44	124.313,12	124.313,12	124.313,12	117.117,56	592.783,36
504020101000 Canoni noleggio - Area sanitaria	84.607,00	126.910,50	126.910,50	126.910,50	116.334,63	581.673,13
Totale	187.333,44	251.223,62	251.223,62	251.223,62	233.452,19	

ACQUISITA, da parte del Direttore della struttura proponente assegnataria dello stanziamento di budget, l'attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che detti oneri - così come individuati nel dispositivo unitamente ai sottoconti economici di rispettivo riferimento – per l'anno 2020 non comportano alcuno scostamento rispetto al bilancio preventivo economico annuale di cui alla Deliberazione n. 1050 del 24/12/2019 avente oggetto “*Proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011 e ssmii*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/12/2019;

SPECIFICATO CHE per gli esercizi successivi la restante quota parte di detti oneri sarà ricompresa nei bilanci di previsione di rispettivo riferimento;

PRESO ATTO che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

VISTO il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in frontespizio riportato, formulato per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) del Codice, la modifica del contratto avente oggetto il Servizio lavanolo, di cui a Ordinato di fornitura emesso in data 18/11/2019 nei confronti del RTI Servizi Sanitari Integrati S.r.l. (mandataria) / Lavanderia D'Alessio S.r.l. (mandante), giusta Deliberazione n. 832/2019 di recepimento dell'aggiudicazione della gara centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del “Servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, disposta dalla Direzione Centrale Acquisti con Determinazione n. G12153 del 01/10/2018, e per l'effetto disporre l'affidamento al contraente di servizi supplementari per un importo complessivo, per il periodo contrattuale dal 01/01/2020 al 18/11/2024, pari a € 962.669,25 IVA esclusa e, dunque, pari a € 1.174.456,49 IVA inclusa, come da tabella di seguito riportata:

Servizi	Driver Corrispettivo	Prezzo unitario	Totale annuo Iva esclusa	Totale affidamento Iva esclusa
noleggio e lavaggio teleria piana quartiere operatorio	canone mensile noleggio e lavaggio biancheria piana	€ 1.221,00	€ 14.652,00	€ 68.376,00
cinte contenzione di proprietà del PTV	prezzo unitario per lavaggio	€ 0,30	€ 30,00	€ 140,00
camici piombati di proprietà del PTV	prezzo unitario per lavaggio	€ 4,00	€ 120,00	€ 600,00

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Servizi	Driver Corrispettivo	Prezzo unitario	Totale annuo Iva esclusa	Totale affidamento Iva esclusa
teli sollevamento pazienti di proprietà del PTV	prezzo unitario per lavaggio	€ 0,30	€ 30,00	€ 140,00
lavaggio tende di proprietà del PTV	canone annuo comprensivo di 2 lavaggi/anno + smontaggio e rimontaggio tende (circa 4.412mq)	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 155.000,00
materiale ignifugo canone noleggio biancheria piana	prezzo unitario per giornata di degenza	€ 6,10	€ 35.624,00	€ 166.245,33
materiale ignifugo canone <u>noleggio</u> casacca e pantalone pigiama per SPDC	prezzo unitario per noleggio	€ 1,10	€ 6.424,00	€ 29.978,67
materiale ignifugo canone <u>lavaggio</u> casacca e pantalone pigiama per SPDC	prezzo unitario per pezzo lavato	€ 1,10	€ 14.016,00	€ 65.408,00
noleggio materassi antidecubito	prezzo unitario giorno/materasso	€ 2,85	€ 104.025,00	€ 476.781,25
TOTALE			€ 205.921,00	€ 962.669,25

2. di far gravare gli oneri economici di cui al punto 1 sui seguenti sottoconti per gli esercizi di seguito indicati:

Sottoconto	2020	2021	2022	2023	2024	totale
502020101000 Lavanderia	102.726,44	124.313,12	124.313,12	124.313,12	117.117,56	592.783,36
504020101000 Canoni noleggio - Area sanitaria	84.607,00	126.910,50	126.910,50	126.910,50	116.334,63	581.673,13
Totale	187.333,44	251.223,62	251.223,62	251.223,62	233.452,19	

dando atto che la quota di detti oneri parte riferita all'esercizio 2020 non comporta scostamento rispetto al bilancio preventivo economico annuale di cui alla Deliberazione n. 1050 del 24/12/2019 avente oggetto "Proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011 e ssmii", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/12/2019 e che la restante quota parte sarà ricompresa nei bilanci di previsione di rispettivo riferimento;

3. di confermare Responsabile del procedimento la dott.ssa Carla Cianciullo, Direttore UOC Acquisizioni forniture, servizi e lavori, e Direttore dell'esecuzione del contratto il dott. Alessandro Sili, Dirigente UOC Comfort ospedaliero, già nominati con la citata Deliberazione di recepimento n. 832/2019;

4. di dare mandato al Responsabile del procedimento di espletare tutte le incombenze amministrative. La presente deliberazione è composta di n. 6 pagine (comprensive del frontespizio) e di n. 3 allegati parte integrante e sostanziale così costituiti:

- Allegato 1 - Nota del DEC e del RUP richiesta modifica contratto costituita da n. 2 pagine;
- Allegato 2 - Offerta tecnica ed economica costituita da n. 3 pagine;
- Allegato 3 - Nota del DEC e del RUP valutazione congruità offerta costituita da n. 1 pagine.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *online* sul sito *web* istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.

TIZIANA FRITTELLI
Commissario straordinario

Alla c.a. UOC Acquisizioni

Oggetto: proposta di valutazione di modifica del contratto Servizio Lavanolo ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del Codice

Si fa riferimento alla "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio" suddivisa in 8 Lotti indetta dalla Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio con Determinazione n. G16423 del 28/12/2016 e aggiudicata con successiva Determinazione n. G12153 del 01/10/2018.

Per il Lotto 4 della suddetta procedura – comprensivo del fabbisogno del Policlinico Tor Vergata e dell'ASL Roma 6 - è risultato aggiudicatario il raggruppamento costituito dagli operatori economici Servizi Sanitari Integrati S.r.l. (mandataria) e Lavanderia D'Alessio S.r.l. (mandante);

Con Deliberazione n. 832 del 04/10/2019, il PTV ha recepito l'esito dell'aggiudicazione della citata procedura centralizzata regionale e emesso relativo Ordinativo di fornitura comprendente i seguenti servizi previsti in da gara:

- Giornata di degenza ordinaria (comprensivo di noleggio e lavaggio di teleria piana, copri letto, materassi, cuscini, coperte)
- Giornata di degenza Day Hospital e Day Surgery (comprensivo di noleggio e lavaggio di teleria piana, copri letto, cuscini)
- Accessi al pronto Soccorso (comprensivo di noleggio e lavaggio di teleria piana, coperte)
- Operatori addetti vestiti al giorno

Si rileva che il PTV, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in situazione di sicurezza sotto il profilo igienico, necessita altresì di specifici servizi indispensabili ma non ricompresi nella gara centralizzata; gli stessi presentano, tuttavia, caratteristiche omogenee a quelle previste nell'ambito dell'attuale Servizio lavanolo.

Si tratta di attività di noleggio di biancheria piana, anche ignifuga da destinare al SPDC, di lavaggio della stessa, di lavaggio di articoli in tessuto di proprietà del PTV (cinte di contenzione, teli solleva pazienti, tendaggi) nonché di noleggio e sanificazione di materassi antidecubito (come noto il PTV non ha espletato la procedura per il noleggio di materassi antidecubito essendo la stessa ricompresa nell'elenco delle procedure di competenza della Centrale Acquisti della Regione Lazio).

Di seguito si riporta l'elenco di tali servizi non inclusi nell'appalto iniziale elaborato dalla Regione Lazio per i quali si propone anche il driver dei corrispettivi da proporre all'esecutore del servizio di lavanolo, raggruppamento costituito dagli operatori economici Servizi Sanitari Integrati S.r.l. (mandataria) e Lavanderia D'Alessio S.r.l. (mandante):

SERVIZI	DRIVER CORRISPETTIVO	QUANTITÀ
noleggio e lavaggio teleria piana quartiere operatorio	canone mensile noleggio e lavaggio biancheria piana	n. 100 lenzuola n. 10 federe n. 60 traverse cotone n. 10 copriletto
cinte contenzione di proprietà del ptv	prezzo unitario per lavaggio	
camici piombati di proprietà del ptv	prezzo unitario per lavaggio	
teli sollevamento pazienti di proprietà del ptv	prezzo unitario per lavaggio	
lavaggio tende di proprietà del ptv	canone annuo comprensivo di 2 lavaggi/anno + smontaggio e rimontaggio tende (circa 4.412mq)	mq 4.412 (complessivi tendaggi)
materiale ignifugo canone noleggio biancheria piana	prezzo unitario per giornata di degenza	gg degenza anno 2019 n. 5840
materiale ignifugo canone <u>noleggio</u> casacca e pantalone pigiama per SPDC	prezzo unitario per noleggio	circa 30 pigiami (per 16 p.l.)
materiale ignifugo canone <u>lavaggio</u> casacca e pantalone pigiama per SPDC	prezzo unitario per pezzo lavato	circa 1.550 lavaggi anno
noleggio materassi antidecubito	prezzo unitario giorno/materasso	n. 100 materassi

L'affidamento allo stesso esecutore del servizio di lavano consente di realizzare evidenti sinergie derivanti dalla possibilità di utilizzare il medesimo personale dell'aggiudicatario già presente quotidianamente presso il PTV per le attività di consegna e ritiro della biancheria, di unificare gli spazi per lo stoccaggio già assegnati all'esecutore del servizio di lavano nonché di snellire il processo amministrativo potendo disporre di un solo interlocutore nella gestione degli articoli occorrenti l'allestimento di letti di degenza, di day hospital e day surgery, del pronto soccorso etc..

Alla luce di quanto sopra esposto, appare opportuno richiedere una offerta economica al fornitore indicando le apposite condizioni di fornitura al fine di valutare l'opportunità di procedere alla modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett.b) del Codice e sfruttare gli aspetti sinergici e convenienti per il PTV.


In caso di formalizzazione della modifica contrattuale in parola tutti i servizi avrebbero decorrenza dal 1 aprile 2020 fatta eccezione del noleggio di materassi antidecubito la cui decorrenza avrebbe inizio in data 1 maggio 2020.

I servizi avrebbero scadenza corrispondente alla scadenza naturale del contratto.


Cordiali saluti

Roma, 20 febbraio 2020

IL DEC
Alessandro Sili



II RUP
Carla Cianciullo



Carla Cianciullo

Da: info <info@servizisanitariintegrati.it>
Inviato: lunedì 16 marzo 2020 16:29
A: gare@ptvonline.postecert.it
Oggetto: Re: richiesta offerta per servizi supplementari ex art. 106 del 1 lett. b) del Codice al servizio lavanolo
Allegati: offerta servizi supplementari_REV. 1.pdf

Si invia in allegato offerta revisionata.

Servizi Sanitari Integrati Srl

Da: "info" info@servizisanitariintegrati.it
 A: gare@ptvonline.postecert.it
 Cc:
 Data: Thu, 12 Mar 2020 15:49:02 +0100
 Oggetto: Re: richiesta offerta per servizi supplementari ex art. 106 del 1 lett. b) del Codice al servizio lavanolo

> Si invia in allegato l'offerta richiesta.

> Cordiali saluti,

> Servizi Sanitari Integrati Srl

> Da: "gare@ptvonline.postecert.it" gare@ptvonline.postecert.it
 > A: info@servizisanitariintegrati.it
 > Cc:
 > Data: Thu, 12 Mar 2020 13:23:18 +0100 (CET)
 > Oggetto: richiesta offerta per servizi supplementari ex art. 106 del 1 lett. b) del Codice al servizio lavanolo

> > Si fa riferimento al servizio di lavanolo (noleggio e lavaggio biancheria piana, divise e materassi) in esecuzione presso il PTV da parte di codesto RTI giusta Deliberazione n. 832 del 04/10/2019 di recepimento dell'esito della gara regionale per il Lotto 4 di competenza.

> > Come noto il Lotto 4 della citata gara regionale e, in particolare, l'aggiudicazione relativa a questa Fondazione, non ricomprende alcuni servizi, non inclusi nell'appalto iniziale, essenziali per la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie del PTV, assimilabili al servizio lavanolo per omogeneità di attività, sinergia nell'esecuzione delle prestazioni ed economicità.

> > A tal fine si invia apposita tabella nella quale, per singolo servizio richiesto non ricompreso nell'appalto iniziale, sono indicate le quantità annue presuntive e si chiede di presentare relativa offerta.

> > Il RUP

> > Dott.ssa Carla Cianciullo

> > _____
 > > Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
 > > UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori
 > > Ufficio gare

PRESIDIO		QUANTITA'	Prezzo unitario € IVA esclusa	Totale	Prezzo applicato	
Quartiere operatorio	CANONE MENSILE noleggio e lavaggio biancheria piana n. 10 lenzuola n. 10 federe n. 60 traverse cotone n. 10 copriletto			€ 14.652,00	Offerta ex novo	Canone annuo
CINTE CONTENZIONE	PREZZO UNITARIO per lavaggio	100	€ 0,30		Offerta ex novo	Canone a consumo
CAMICI PIOMBATI	PREZZO UNITARIO per lavaggio	30	€ 4,00		Offerta ex novo	Canone a consumo
TELI SOLLEVAMENTO PAZIENTI	PREZZO UNITARIO per lavaggio	100	€ 0,30		Offerta ex novo	Canone a consumo
Lavaggio tende	CANONE ANNUO comprensivo di 2 lavaggi/anno + smontaggio e rimontaggio tende (circa 4.412mq)		€ 31.000,00	€ 31.000,00	Offerta ex novo	Canone annuo comprensivo di 2 lavaggi/anno + smontaggio e rimontaggio tende*MQ 4.412
Materiale ignifugo canone noleggio biancheria piana	PREZZO UNITARIO per giornata di degenza	5840	€ 6,10	€ 35.624,00	Offerta ex novo	PREZZO UNITARIO PER GIORNATA DI DEGENZA
Materiale ignifugo canone noleggio pigiami (casacca + pantalone)	PREZZO UNITARIO per noleggio	16	€ 1,10	€ 6.424,00	Offerta ex novo	POSTO LETTO PRODIE
Materiale ignifugo lavaggio casacca pantalone	PREZZO UNITARIO per pezzo lavato	11680	€ 1,20	€ 14.016,00	Offerta ex novo	PREZZO UNITARIO LAVAGGIO CASACCA + PANTALONE A FORFAIT (VUOTO PER PIENO)
Noleggio materassi antidecubito	PREZZO UNITARIO per giorno/materasso	100	€ 2,85	€ 104.025,00	Offerta ex novo	PREZZO UNITARIO giorno/materasso
TOTALE			€	€ 205.741,00		

e

ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP

LOGIC RANGE

SISTEMA MATERASSO
E SOVRAMATERASSO





...with people in mind



SISTEMA COMPLETAMENTE SOSTITUTIVO DEL MATERASSO OSPEDALIERO E SOVRAMATERASSO

Il sistema antidecubito *Auto logic*® 200 e il sovrामaterasso *Auto logic* 110 fanno parte della nuova gamma di prodotti logic di ArjoHuntleigh. Questa linea di prodotti, sviluppata e realizzata con tecnologia all'avanguardia, comprende due sistemi antidecubito completamente automatici ed un cuscino terapeutico. La gamma completa di sistemi *Auto logic* è consigliata per una prevenzione ed un trattamento continui per lesioni da pressione fino al quarto grado, che richiederebbero un monitoraggio, un'assistenza infermieristica e un riposizionamento frequenti.

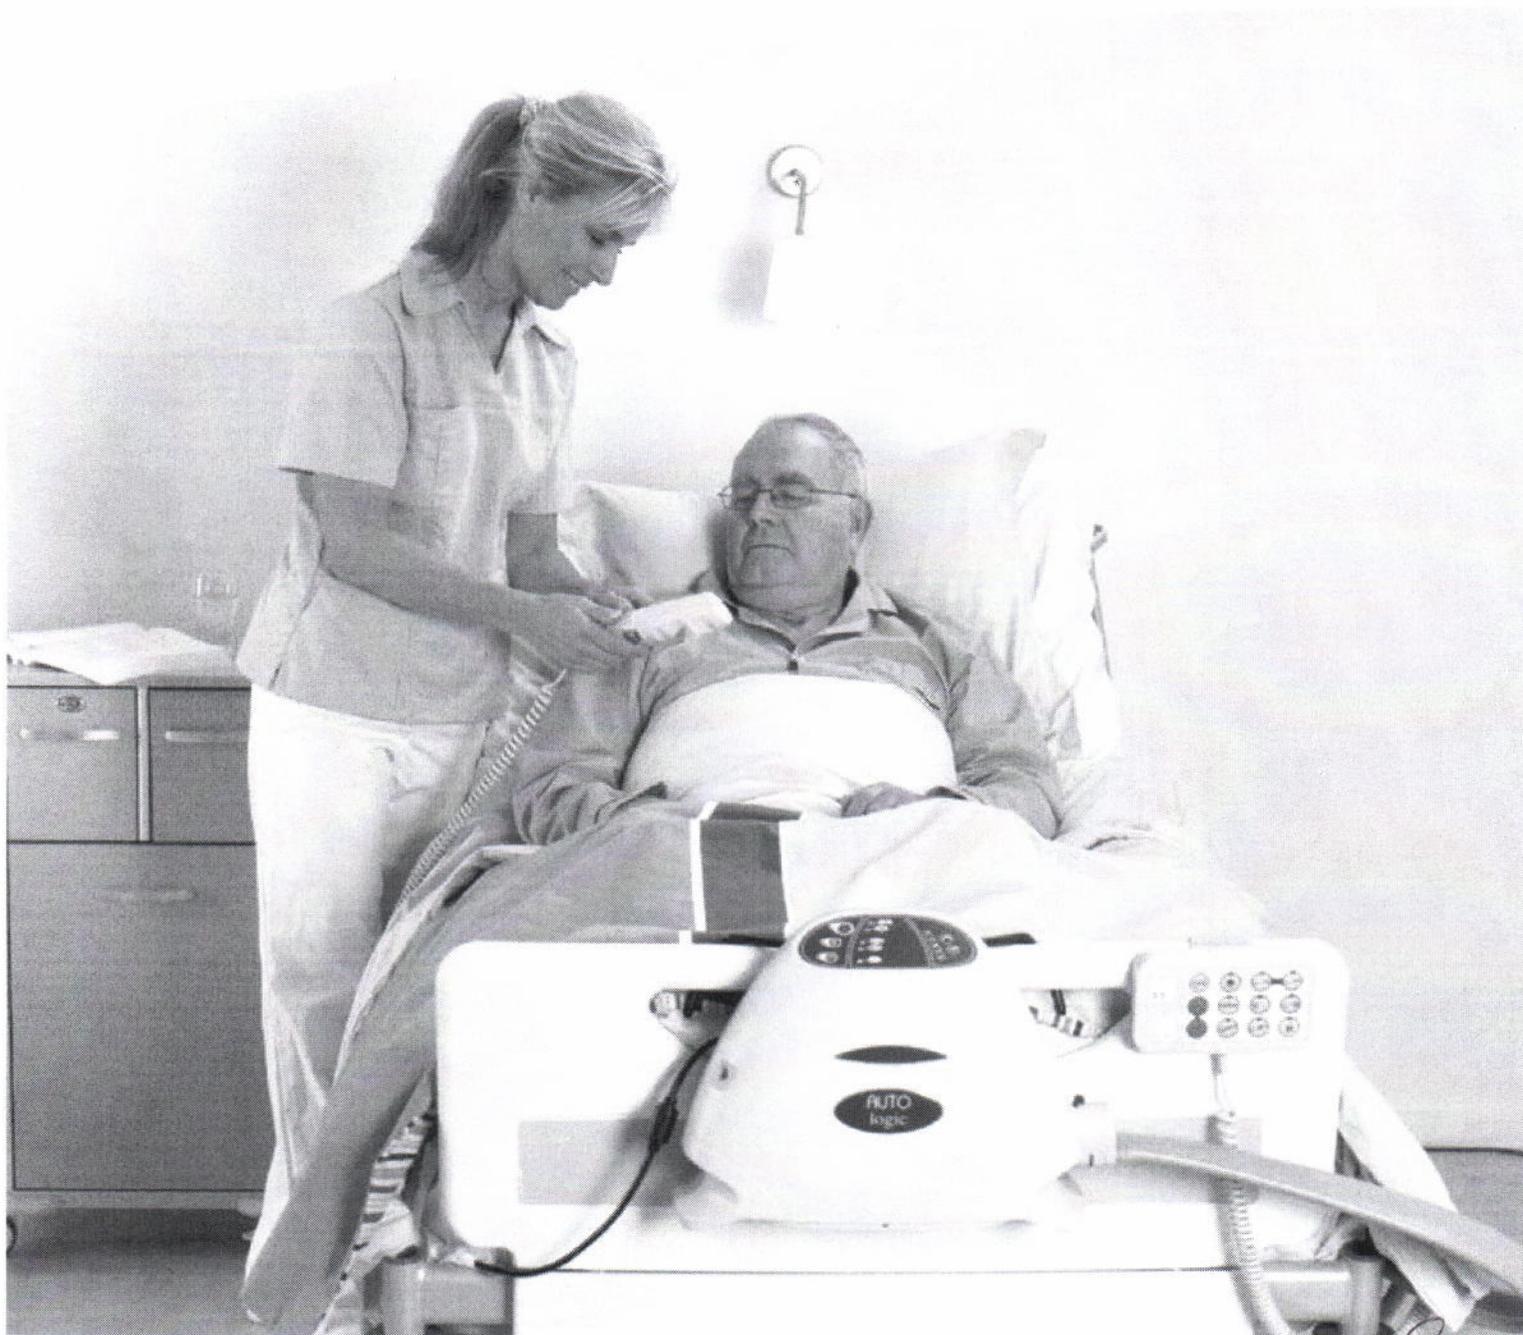


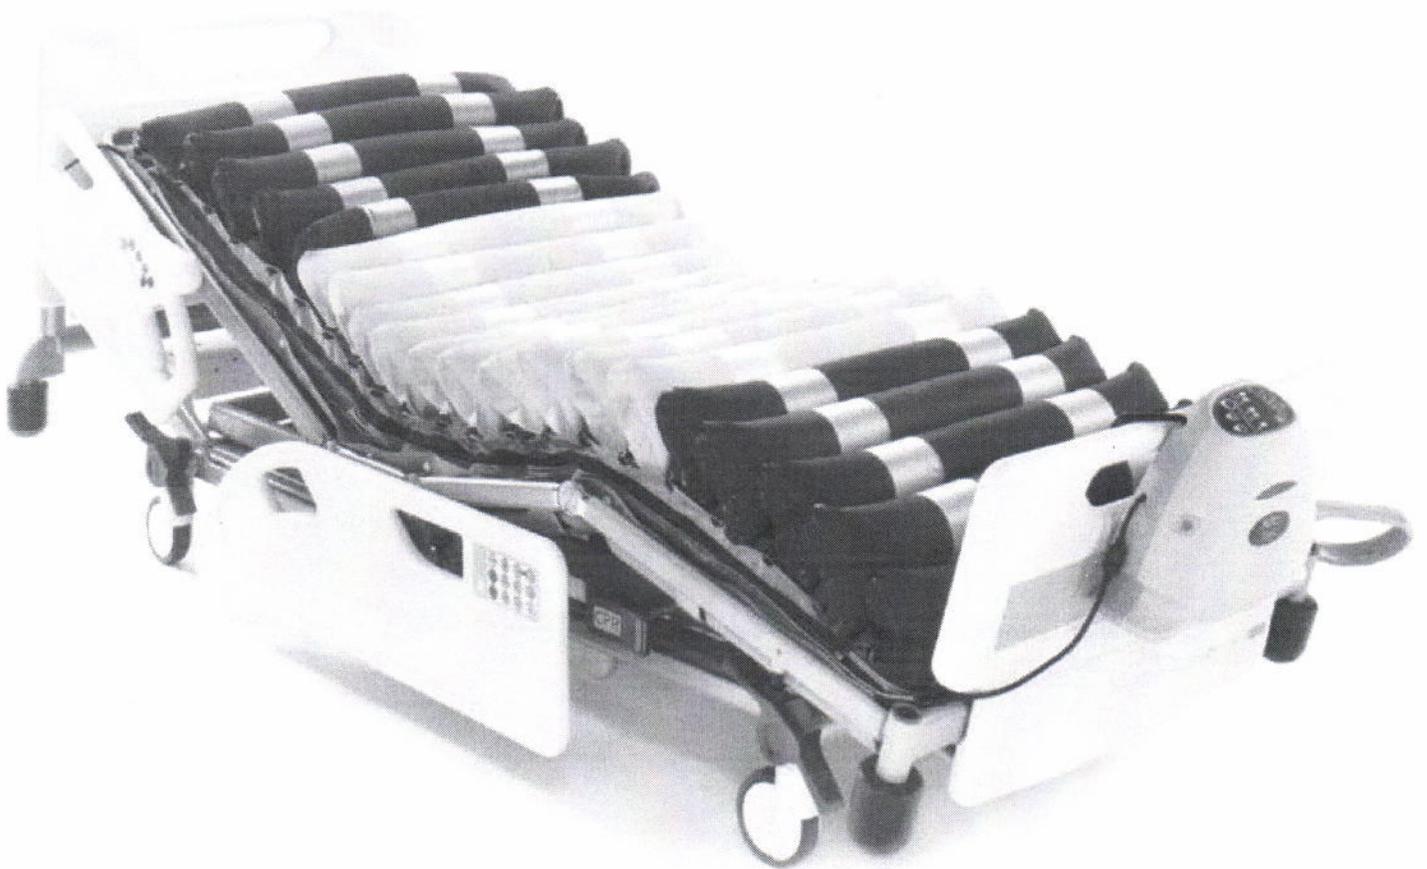

SELF SET TECHNOLOGY: UNA TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA


Dimenticatevi dell'impostazione manuale del compressore fino ad ora necessaria durante l'installazione dei sistemi antidecubito. Per un'ottimale gestione delle zone di pressione in pazienti valutati ad alto rischio di sviluppo di lesioni da decubito il Sistema *Auto logic* utilizza la Self Set Technology (SST) un'innovativa tecnologia, in grado di controllare automaticamente la pressione interna del materasso. Durante entrambe le differenti modalità di funzionamento del sistema, Modalità Alternata (Attiva) e Bassa Pressione Continua (Reattiva), un avanzato microprocessore analizza con regolarità la distribuzione della massa corporea del paziente e riequilibra le pressioni interne alle celle per adattarsi ad ogni singola esigenza.

SISTEMA DALLA STRUTTURA ESCLUSIVA

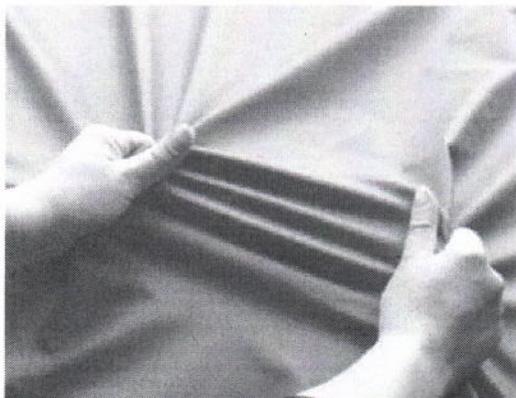


Assortimento teli di copertura

- Copertura standard – Per uso generale
- Telo *Advantex*® – Offre una elevata scorrevolezza diminuendo il rischio di frizioni ed una maggiore permeabilità al vapore
- Telo *eVent*® – Per pazienti che necessitano di una copertura permeabile all'aria

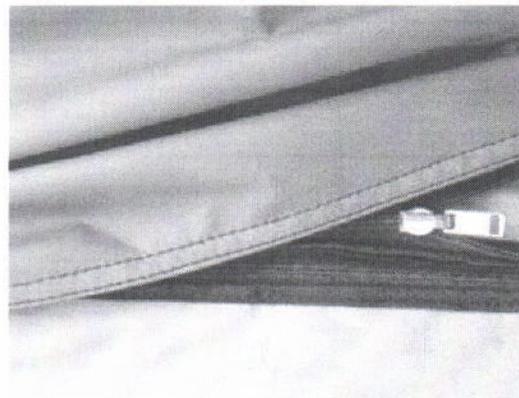


Zip nascoste

- Ruolo proattivo nel controllo delle infezioni

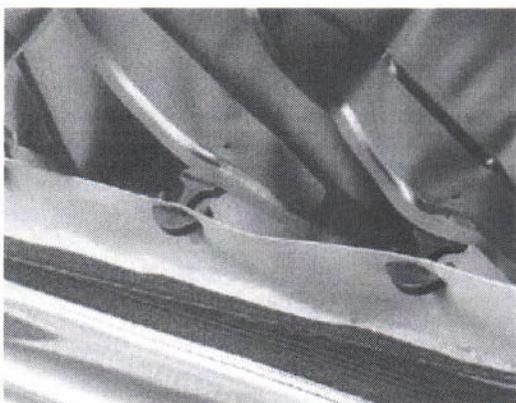

Bloccaggio celle

- Ganci di sicurezza esclusivi in sostituzione dei tradizionali bottoni
- Approccio proattivo al controllo delle infezioni e alla manutenzione del materasso

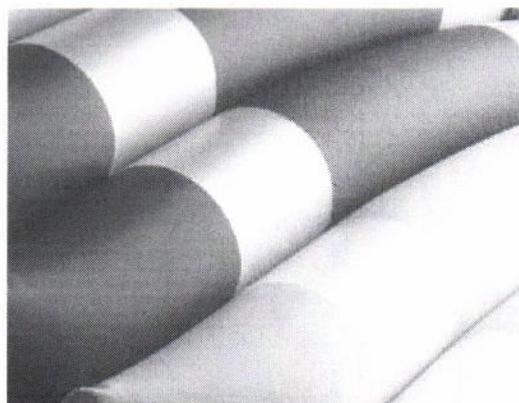

Forma curvata delle celle

- Previene lo scivolamento verso il basso del paziente

Conformazione “Cella in Cella”

- Mantiene il paziente sul materasso in posizione centrale
- Aumenta la stabilità e favorisce lo spostamento ed il trasferimento del paziente

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA




Microcessione d'Aria

- Favorisce la riduzione dell'umidità in corrispondenza dell'interfaccia del materasso




CPR Control

- Sgonfiamento rapido (in circa 10 secondi) per favorire la rianimazione
- Operazione semplice che richiede l'uso di una sola mano
- Posizionato in corrispondenza della testa del letto

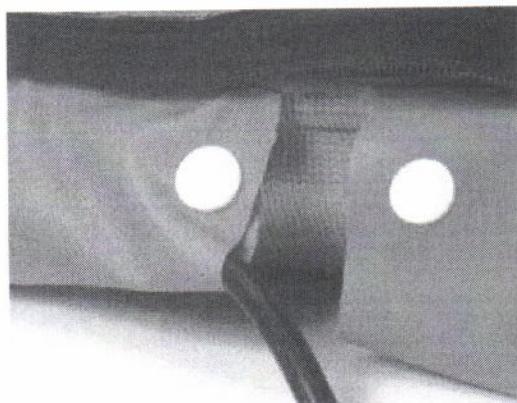

Alloggiamento dei cavi

- Consente di non avere cavi di ingombro sul pavimento o a vista

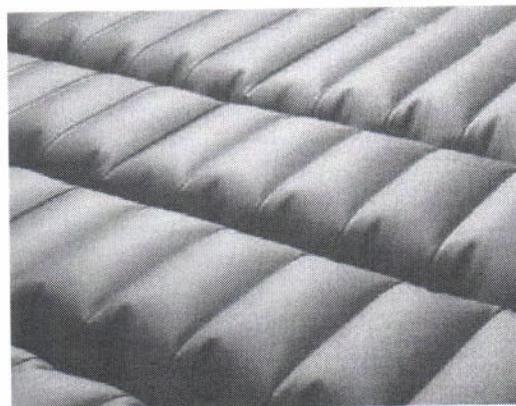

Sotto-materasso ad aria

Il sistema *Auto logic 200* può essere convertito e utilizzato come sovr materasso aprendo la cerniera del sotto-materasso ad aria.


- Permette al sistema di essere utilizzato in versione sovr materasso
- Le zone longitudinali che lo compongono aiutano il trasferimento del paziente
- Base del materasso in nuovo materiale antiscivolo

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA



Batteria (opzionale)

Garantisce un minimo di 6 ore di terapia in caso di interruzione di corrente o di trasporto attivo in sala operatoria o in radiologia.

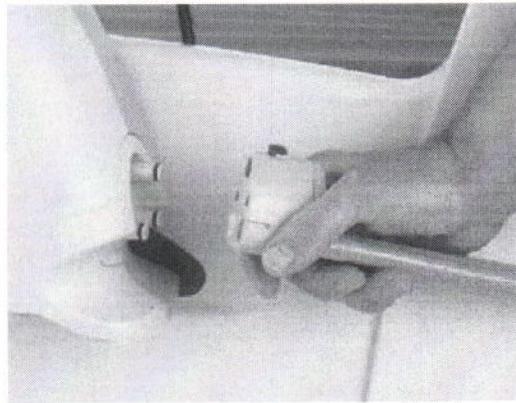

Trasporto

Si attua semplicemente scollegando i connettori dal compressore. La pressione interna delle celle si stabilizza e si uniforma in tutto il sistema garantendo il sostegno del paziente per oltre 12 ore.




Cinghie di ancoraggio

Fissate sulla base del materasso, in materiale antiscivolo, consentono un sicuro aggancio del sistema a tutte le tipologie di letto.



24 H di tranquillità

Il cuscino *Aura logic*®, in combinazione con i sistemi *Auto logic*, è in grado di offrire una prevenzione e un trattamento continui per le lesioni da pressione. Per praticità di utilizzo, la pompa *Auto logic* rileva automaticamente quale sistema è stato collegato.

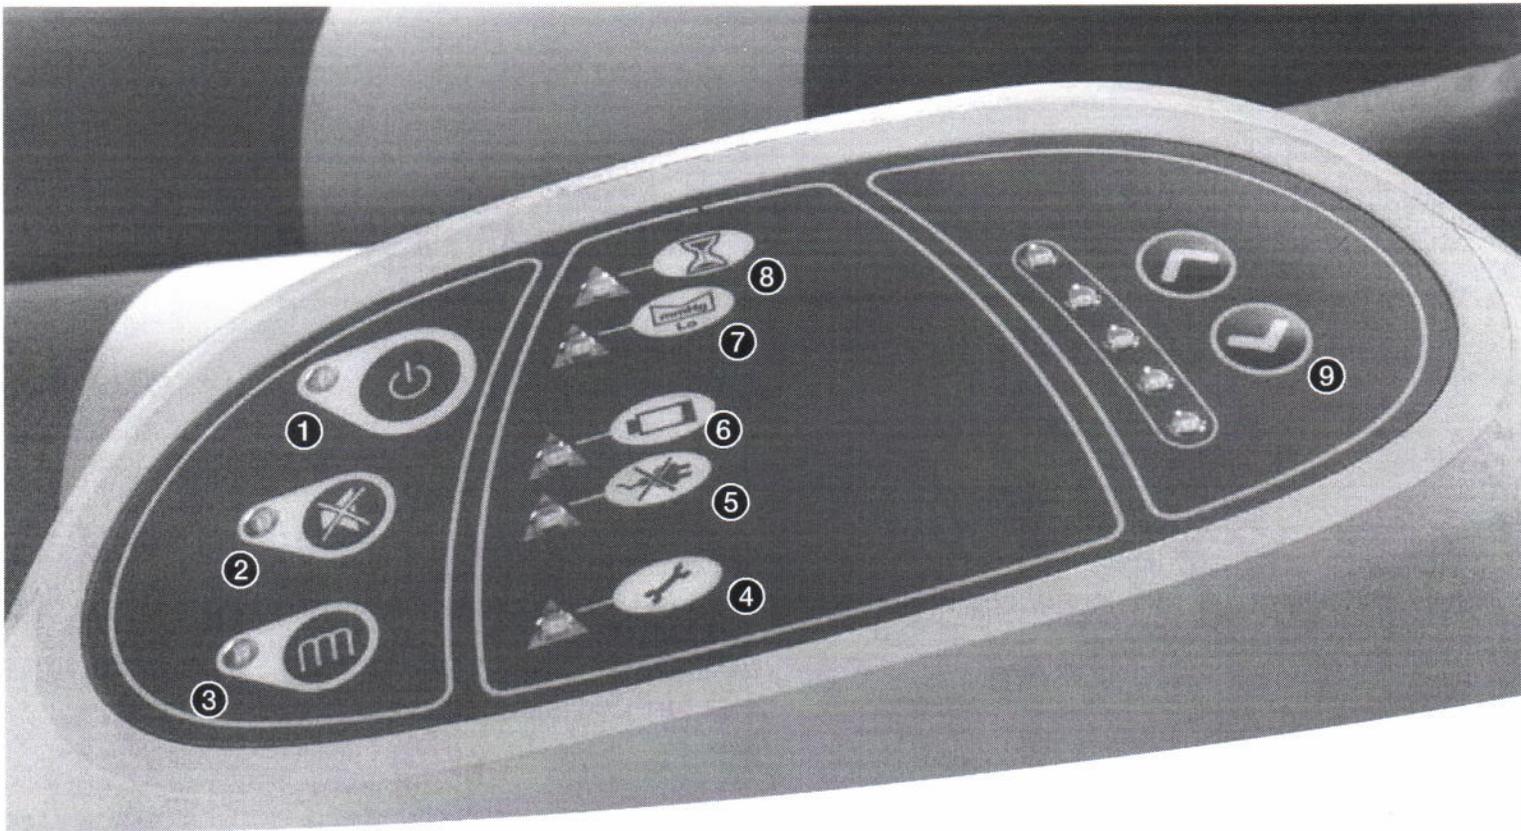

DUE SISTEMI IN UNO

Il sistema può operare in differenti modalità per una corretta gestione delle aree di pressione:

- *Modalità Alternata (Attiva)*
- *Modalità di Bassa Pressione Continua (Reattiva)*

1 Pulsante Start/Standby

Accende o spegne l'unità pompa.

2 Pulsante disattivazione suoni (MUTE)

Disattiva tutti i segnali acustici, tranne l'interruzione di corrente.

3 Modalità di Bassa Pressione Continua

Offre una eccellente superficie a riduzione di pressione, nel caso di controindicazione all'uso di superfici mobili o per agevolare procedure di nursing.

4 Spia manutenzione

Si accende per indicare che la pompa necessita di assistenza tecnica lampeggia quando viene rilevato un malfunzionamento.

5 Allarme interruzione di corrente

Segnale acustico e visivo in caso di interruzione di corrente.

6 Indicatore di carica della Batteria

Si illumina 2 ore prima che la batteria sia completamente scarica emettendo, emettendo un allarme acustico un'ora prima dell'esaurimento della stessa.

7 Allarme di Bassa Pressione

Si illumina quando la pompa rileva una Bassa Pressione nel materasso o nel cuscino. Si attiva inoltre un allarme acustico a meno che non sia stata impostata la modalità silenziosa.

8 Indicatore Inizio terapia

Resta acceso fino a che il materasso/cuscino non è completamente in funzione terapeutica.

9 Comando Comfort

Semplice regolazione per ottenere una superficie più soffice o più rigida, migliorando il comfort del paziente senza compromettere la terapia.

SPECIFICHE TECNICHE

Informazioni di prodotto			
	Sovramaterasso Auto logic 110	Materasso Auto logic 200	Cuscino Aura logic
Lunghezza	2030 mm	2030 mm	470 mm
Larghezza	860 mm	860 mm	455 mm
Altezza	115 mm	205 mm	50 mm minimo
Sotto materasso ad aria	2030 mm x 860 mm x 90 mm		
Materiale celle	Poliuretano (PU)	Poliuretano (PU)	Poliuretano (PU)
Materiale della base	Nylon rivestito in poliuretano	Nylon rivestito in poliuretano	
Portata terapeutica	200 kg	200 kg	200 kg



Pompa	
Lunghezza	375 mm
Altezza	280 mm
Profondità	125 mm
Peso	2,75 kg
Materiale della struttura	ABS Ignifugo
Modo di funzionamento	Continuo
Tensione di alimentazione	100 - 240 VAC/50 - 60 Hz
Potenza elettrica nominale	85 VA MAX
Ciclo di funzionamento	10 minuti
Livello di protezione contro le scosse elettriche	Classe II Tipo BF
Livello di protezione contro la penetrazione dei liquidi	IPX0

ArjoHuntleigh è una filiale di Arjo Med Ltd AB.
 ArjoHuntleigh raccomanda di utilizzare i suoi prodotti solo con componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da ArjoHuntleigh.
 Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti, ArjoHuntleigh si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso.
 ® e ™ sono marchi registrati delle aziende del Gruppo ArjoHuntleigh. © ArjoHuntleigh, 2010.

ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP

www.ArjoHuntleigh.it

GETINGE GROUP è leader globale nella fornitura di prodotti e sistemi che contribuiscono a migliorare la qualità e l'accessibilità delle soluzioni nel settore delle scienze dedicate alla vita e alla salute. Operiamo con i seguenti tre marchi **ArjoHuntleigh**, **GETINGE** e **MAQUET**. **ArjoHuntleigh** concentra la propria attenzione su mobilità del paziente e soluzioni per la gestione delle lesioni. **GETINGE** fornisce soluzioni per il controllo delle infezioni nelle strutture assistenziali e per la prevenzione delle contaminazioni biologiche. **MAQUET** è specializzata in soluzioni, terapie e prodotti per interventi chirurgici e cure intensive.

ArjoHuntleigh Spa
 Via di Tor Vergata 432
 00133 ROMA
 Telefono: +39 06 87426211
 Fax: +39 06 87426222
 E-mail: Italy.Promo@ArjoHuntleigh.com




Arjo

Autologic® 200

Superficie terapeutica
a Bassa Pressione Alternata e a Bassa Pressione Continua

ARJOHUNTLEIGH
GETINGE GROUP

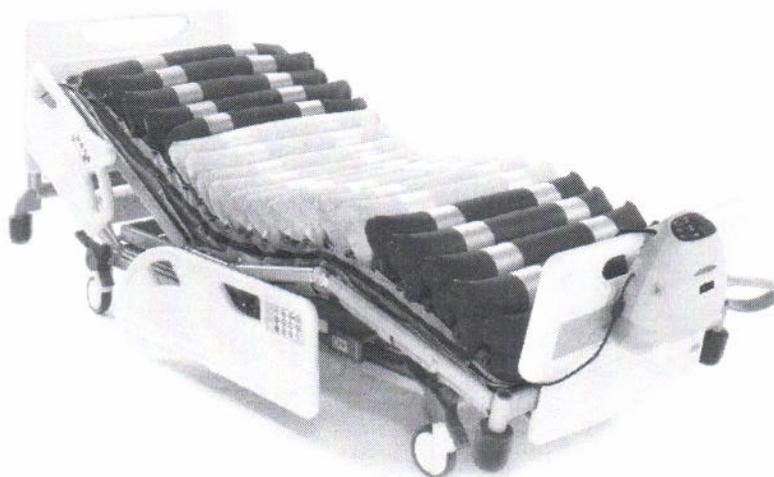

Descrizione prodotto

La superficie terapeutica Autologic 200 è un sistema interattivo capace di autodeterminare la necessità di un adeguato supporto terapeutico al paziente senza alcun intervento di valutazione e correzione pressoria da parte dell'operatore.

La superficie terapeutica Autologic 200 è sostitutivo del materasso ospedaliero, ed è composta da una Unità di Controllo e da una superficie terapeutica composta da 20 celle indipendenti in poliuretano sotto le quali è presente un supporto ad aria che garantisce una pressione uniforme e costante regolata da sensore.

Con un'altezza totale del sistema di 20,5 cm, l'Autologic® 200 offre una doppia modalità di funzionamento, Bassa Pressione Alternata e Bassa Pressione Continua, consentendo all'operatore di scegliere la terapia più adeguata alle condizioni cliniche del paziente.

La Bassa Pressione Alternata fornisce un'efficace redistribuzione della pressione di contatto mediante l'alternanza dei punti d'appoggio secondo un ciclo fisiologico di 10 minuti. In modalità Bassa Pressione Continua tutte le celle sono posizionate alla stessa altezza e regolate da un sensore di controllo in questo modo si ottiene un piano di appoggio perfettamente uniforme con basse pressioni di contatto costantemente regolate dal sensore attivo. Il sensore SST (Self Set Technology) attivo sia sulla Bassa Pressione Continua sia sulla Bassa Pressione Alternata, regola in automatico le pressioni di contatto in base al peso, alla posizione del paziente e all'articolazione del letto.

È indicato per la prevenzione ed il trattamento di tutti i gradi di ulcere da decubito, è finalizzato all'alta terapia ed è consigliato per una prevenzione e trattamento continuo delle lesioni fino al IV grado che richiederebbero un monitoraggio, un'assistenza infermieristica e un riposizionamento frequente del paziente. Ha una portata terapeutica di 200 kg ed è compatibile con tutti i letti ospedalieri, grazie alle due dimensioni a disposizione.

Caratteristiche e benefici


La superficie terapeutica Autologic 200 è indicata per la prevenzione e la cura delle lesioni da decubito, il sistema è costituito da una superficie antidecubito formata da celle, e da un supporto ad aria in poliuretano regolato dal sensore SST. La gamma Logic[®] comprende anche un sovrasmaterasso antidecubito (Autologic 110), una superficie antidecubito (Autologic 175) ed un cuscino a pressione alternata antidecubito (Aura Logic) per fornire una terapia completa 24 ore su 24.

Il set di tubi flessibili è fissato alla superficie antidecubito ed è dotato di un connettore che, grazie ad un chip, rileva automaticamente quale presidio è stato collegato.



La superficie terapeutica Autologic 200 è suddivisa in quattro sezioni di supporto:

1. **Sezione Nuca:** le tre celle della testa, non effettuano l'alternanza, per evitare l'effetto nausea, ma mantengono un supporto costante per il sostegno in sicurezza del capo, la modalità di funzionamento è sempre a Bassa Pressione Continua.
2. **Sezione Tronco:** sono dodici le celle dedicate a supportare il paziente in qualunque posizione, ed seguono fedelmente la morfologia del paziente, assicurandone la stabilità, Esse si distinguono per la tecnologia Cella in Cella, garantendo sempre un'azione terapeutica del sistema evitando il rischio di affossamento (bottom out), il funzionamento può essere a Bassa Pressione Continua e a Bassa Pressione Alternata.
3. **Supporto Laterale Ortostatico Per Il Contenimento Laterale Del Paziente,** questa sezione è stata specificatamente studiata per dare maggior supporto al paziente e all'operatore nelle manovre di salita e discesa dal letto, evitando il rischio di cadute laterale del paziente.
4. **Sezione Arti Inferiori:** le cinque celle nella zona talloni funzionano con delle pressioni più basse rispetto al sistema, ideale per la gestione degli arti inferiori. il funzionamento può essere a Bassa Pressione Continua e a Bassa Pressione Alternata.

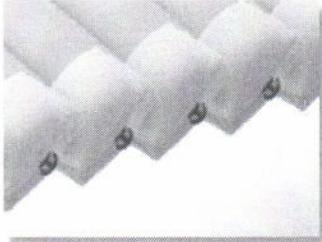

Nella Sezione Tronco, la tecnologia *Cella in Cella*, è stata sviluppata allo scopo di mantenere il paziente su un piano stabile, facilitando gli spostamenti e i trasferimenti del paziente e il posizionamento laterale durante le manovre di nursing.




Il comando CPR (rianimazione cardio polmonare) - posizionato angolarmente sul lato sinistro della testa del presidio si attiva rapidamente con una sola mano, e sgonfia l'intera superficie in meno di 10 secondi. Terminata l'emergenza, è sufficiente riportare tale comando nella posizione antecedente per riattivare la superficie.




La modalità TRANSPORT garantisce fino a 12 ore di autonomia durante il trasporto e in caso di mancanza di energia elettrica. Si attiva semplicemente sganciando il dispositivo di innesto della superficie antidecubito dall'unità di controllo. E' realizzata in modo tale da non interferire con la gestione infermieristica.



Le cinghiette presenti sui lati della superficie antidecubito consentono il fissaggio stabile al letto. Collocate ad opportuna distanza impediscono lo scivolamento della superficie. La base della superficie è realizzata in materiale anti-scivolo per migliorarne la stabilità.

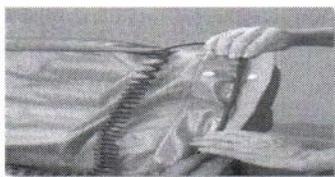


Il cavo di alimentazione ha un apposito alloggiamento di lato alla superficie che ne evita lo stazionamento a terra e che riduce sensibilmente il rischio di cadute degli operatori. È lungo 6 metri (3 m. in linea e 3 m. spiralati).

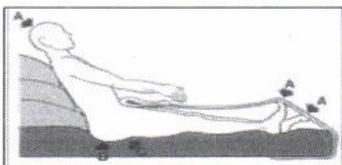

La gestione del decubito ortopnoico (GDO) è garantita in maniera interattiva senza alcuna programmazione manuale, quindi qualsiasi tipo di seduta o posizione laterale viene fatta assumere al paziente, il sensore adegua immediatamente le pressioni in modo da garantire un efficace supporto terapeutico.

Telo di Copertura


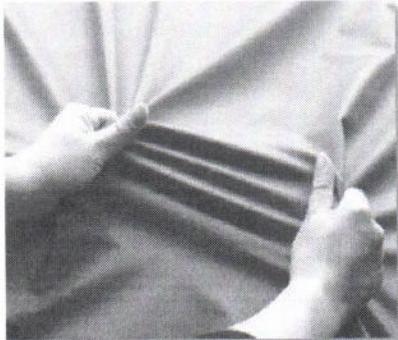


L'Autologic® 200 offre tre diverse tipologie di coperture permeabili al vapore e resistenti all'acqua che garantiscono una riduzione delle forze d'attrito e frizione.

Nella versione standard viene fornita la copertura in materiale **Reliant IS²** che, grazie al trattamento **Actifresh**, assicura una funzione antimicrobica, fungistatica, antimicotica e batteriostatica. Questo tipo di trattamento resistente ai lavaggi rende la superficie protetta anche dai cattivi odori dovuti alla decomposizione di cellule epiteliali, fecali e urine. L'elasticità bidirezionale della copertura permette una sensibile riduzione dell'effetto amaca e delle forze di taglio e frizione.

È resistente al fuoco ed è completamente asportabile per il lavaggio e sanificazione.


Sono inoltre disponibili altre due coperture la **Glide IS²**, che offre una elevata scorrevolezza diminuendo il rischio di frizioni, ottima per la movimentazione dei pazienti in sovrappeso ed obesi e la **Ventilate IS²** permeabile all'aria e ai vapori, per una migliore gestione del microclima cutaneo. La copertura è unita alla base della superficie tramite cerniere protette da un apposita aletta che elimina la possibilità di ingresso di fluidi indesiderati.

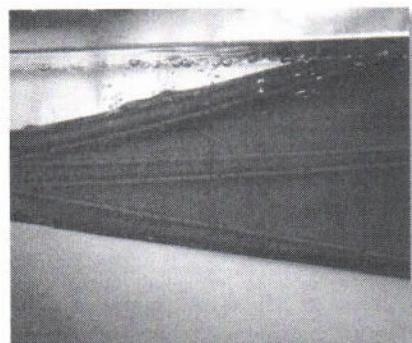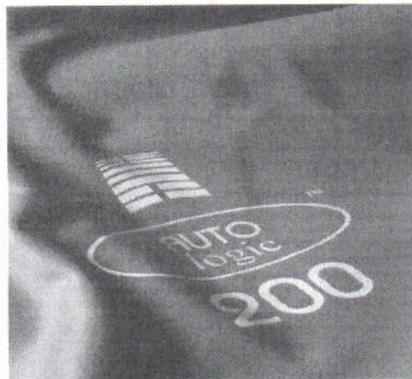

All'interno del rivestimento della superficie è presente un sistema di micro cessione d'aria (**MICRO AIR LOSS**) che, contribuisce gestire il microclima cutaneo del paziente, mantenendo costante la temperatura della cute .

La superficie terapeutica Autologic 200 è completamente radiotrasparente e pertanto agevola qualsiasi tipo di indagine diagnostica. Tutti i componenti del sistema sono privi di contenuti in lattice.

L'UNITA' DI CONTROLLO

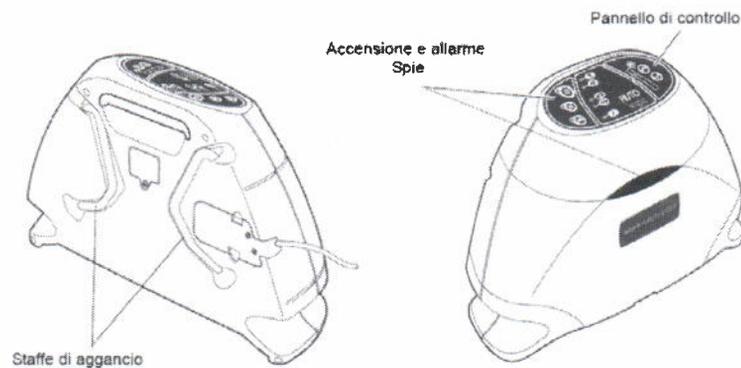


L'unità di controllo è compatta e silenziosa. Il funzionamento della stessa avviene senza vibrazioni e pertanto il suo utilizzo risulta ottimale anche quando è ancorata su letti non di ultima generazione e pertanto sensibili a qualsiasi tipo di vibrazione.

Alla pressione del tasto ON/OFF corrisponde l'accensione, lo standby o lo spegnimento dell'unità di gonfiaggio.

All'atto dell'accensione seguirà un AUTOTEST FUNZIONALE dell'unità, finalizzato a verificare che il sistema sia perfettamente calibrato e non vi siano anomalie di funzionamento. Sempre inserito all'interno del cruscotto dei comandi, posizionato sulla parte frontale della scocca, è presente il tasto di selezione funzionale CLP (BASSA PRESSIONE CONTINUA); premendolo l'operatore ha la possibilità di selezionare un piano di appoggio del paziente perfettamente uniforme con basse pressioni d'interfaccia.


La regolazione del comfort del paziente è impostabile attraverso il dispositivo digitale posto alla destra del cruscotto dei comandi.

Questa regolazione è del tutto opzionale e non interviene in alcun modo nella modifica del supporto al paziente, il cui monitoraggio è delegato al solo sensore di superficie sopra descritto. La regolazione del comfort trova utilità in presenza di paziente vigile il quale desidera ottenere il supporto di appoggio leggermente più rigido o più soffice.

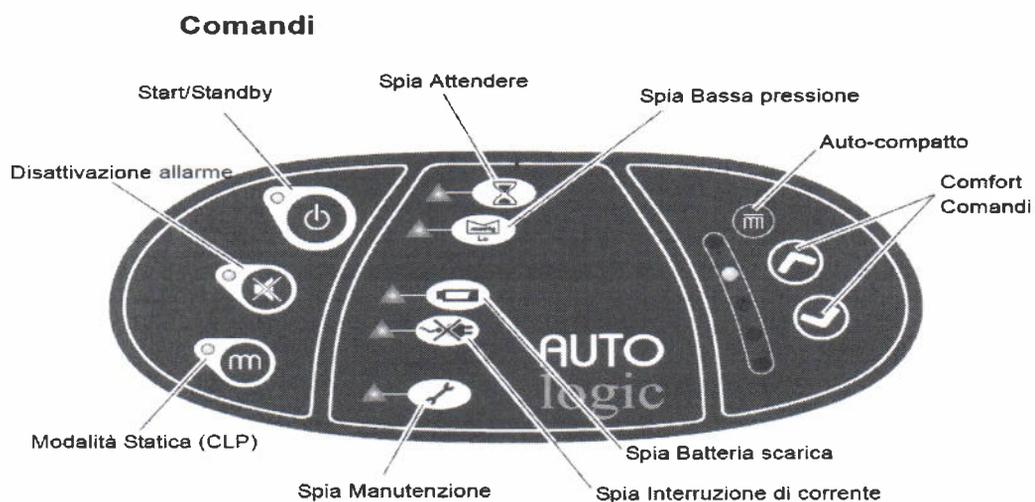


L'unità di controllo si avvale del sensore SELF SET TECHNOLOGY per controllare la pressione d'interfaccia.

Il sensore analizza automaticamente e continuamente la distribuzione del peso, la posizione assunta dal paziente e l'articolazione del letto, riequilibrando le pressioni interne alle celle ad ogni 10 minuti in modalità dinamica e ogni 20 minuti, in modalità bassa pressione continua. L'unità di controllo ha un sistema universale di aggancio al letto. È silenziosa e totalmente priva di vibrazioni.

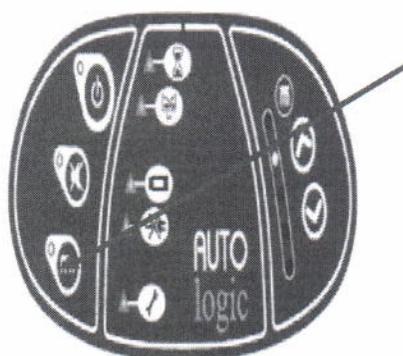


Il tasto Bassa Pressione Continua; consente all'operatore di attivare la modalità terapeutica bassa pressione continua per assicurare al paziente un piano di appoggio conforme alla posizione, al peso e all'articolazione del letto e riduzione delle pressioni di contatto. Per tornare in Pressione Alternata è sufficiente disinserire la funzione Bassa Pressione Continua.

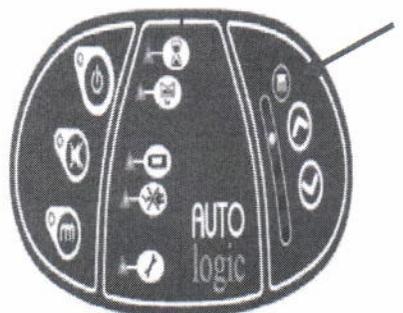

Attivando la funzione AUTO-FIRM gonfiaggio max, la superficie diventa per 15 minuti una piattaforma stabile per l'espletamento delle procedure infermieristiche e per supportare le esigenze di movimentazione e gestione del paziente. Trascorso tale intervallo, l'opzione si disattiva per ritornare automaticamente alla modalità precedente. La modalità Auto-Firm è prolungabile di 5 minuti per volta fino ad un massimo di 30 minuti.

Per disattivare la funzione Auto-Firm premere il pulsante apposito per due secondi.

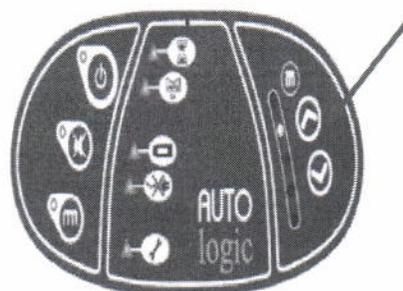

L'opzione COMFORT CONTROL, presente sulla destra nel pannello dei comandi, consente di regolare la rigidità della superficie antidecubito secondo le preferenze del paziente ed il giudizio clinico del personale. Essa non interviene sul supporto al paziente il cui monitoraggio è affidato esclusivamente al sensore SELF SET TECHNOLOGY sopra descritto.

E' possibile applicare in opzione una **batteria** all'unità di controllo per gestire e continuare la terapia fino a 8 ore in caso di interruzione di corrente.
I comandi sono collocati sulla parte superiore della scocca.



L'unità di controllo è dotata di allarmi acustico-visivi tecnologicamente avanzati che segnalano eventuali anomalie:


- bassa pressione;
- mancanza corrente;
- pompa guasta;
- spia servizio assistenza programmata;

La spia a clessidra indica l'analisi delle pressioni di contatto, mentre la spia della batteria indica la carica della batteria quando è in utilizzo la batteria opzionale.

E' presente anche il tasto 'MUTE' (Tacetazione Allarmi), quale funzione per disinserire il segnale acustico qualora si manifestassero allarmi: premendolo l'operatore ha modo di silenziare la parte acustica dell'allarme, mentre quella visiva, continua ad avvertire l'operatore di un problema in atto attraverso l'illuminazione di una apposita icona triangolare posta in posizione ben visibile. Soltanto in seguito alla rimozione del problema riscontrato ed al reset ottenuto attraverso lo spegnimento e la riaccensione del compressore, la spia luminosa si spegnerà.

CUSCINO AURA LOGIC (opzionale):

Il cuscino a pressione alternata *Aura Logic* è composto da un sistema di celle che favoriscono la riduzione pressoria. Può essere usato sia negli ambienti ospedalieri ed assistenziali che a domicilio. Il cuscino va posizionato sopra una sedia o poltrona imbottita. Il cuscino viene azionato dalla pompa Auto Logic, che individua automaticamente a quale sistema sia collegato (cuscino o materasso) e ne regola di conseguenza la pressione. Per poter avere una maggiore riduzione della pressione una volta seduti, per evitare lo scivolamento e la stabilità laterale, il design del cuscino *Aura Logic* è stato ottimizzato adottando una distintiva forma a V. Con la batteria opzionale la terapia attiva ha un'autonomia di 8 ore senza dover restare collegato ad una fonte elettrica mediante il cavo di alimentazione.

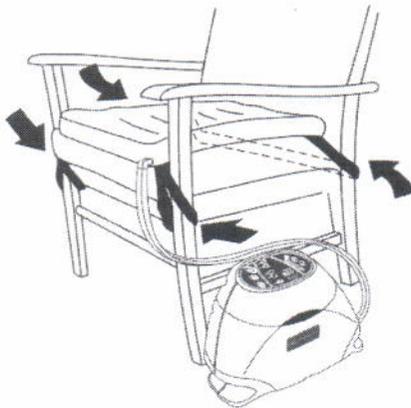

Caratteristiche cuscino Aura Logic:

- Celle a pressione differenziata con ciclo 1 in 2 di 10 minuti
- Telo copertura bi-elastico e removibile
- Sistema di costruzione esclusivo
- Rivestimento inferiore in materiale antiscivolo
- Sgonfiaggio del cuscino tramite pressione delle valvole poste sotto il cuscino
- La batteria (opzionale) fornisce 8 ore di terapia alternante
- Pulsantiera (opzionale) per il paziente
- Portata terapeutica Kg 200
- Dimensioni: cm 47 x cm 45,5 x cm 5 (min)

Alla c.a. UOC Acquisizioni

Oggetto: modifica del contratto Servizio Lavanolo ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del Codice – valutazione dell'offerta pervenuta del RTI Servizi Sanitari Integrati S.r.l. (mandataria) e Lavanderia D'Alessio S.r.l. (mandante)

Si fa riferimento all'offerta per i servizi supplementari richiesta all'operatore in oggetto con nota a mezzo posta elettronica certificata del 12/03/2020 e all'offerta pervenuta in riscontro in data 12/03/2020 e 16/03/2020 via PEC.

Il prezzo offerto in riferimento al “noleggio e lavaggio teleria piana quartiere operatorio” appare congruo in considerazione delle quantità del materiale richiesto e della frequenza del servizio di consegna e ritiro così come appare congruo, rispetto ai prezzi di mercato, il prezzo offerto per il noleggio e lavaggio della teleria piana e pigiami costituiti da materiale ignifugo da destinare al SPDC.


Sono, altresì, congrui i prezzi offerti per il lavaggio di cinte contenzione, di camici piombati e di teli sollevamento pazienti, materiale di proprietà del PTV per i quali si è richiesto il solo servizio di lavaggio su richiesta del DEC o di altro referente del PTV. Con particolare riferimento al lavaggio di camici piombati si rappresenta che il PTV non ha mai affidato tale servizio ma, negli ultimi mesi dell'anno 2019, in considerazione della manifestata esigenza di fornire camici piombati idonei dal punto igienico, è stata svolta una indagine di mercato che ha visto il coinvolgimento di altri operatori. Alla luce di tale indagine il prezzo offerto dall'esecutore del servizio lavanolo appare congruo.

In riferimento al servizio di lavaggio tende, si rappresenta la difficoltà, manifestata più volte dalla UOC Acquisizione, nell'individuare un operatore del mercato disponibile sia al lavaggio dei tendaggi, sia allo smontaggio e rimontaggio degli stessi. In riferimento a tale servizio il prezzo offerto appare congruo anche rispetto ai prezzi di mercato.

In riferimento all'offerta tecnica ed economica dei materassi antidecubito si precisa che il materasso offerto, sotto il profilo tecnico rappresenta un materasso di alta fascia con caratteristiche tecniche molto positive per la cura dei pazienti. Tali presidi garantiscono altresì un alto grado di traspirabilità e igiene della cura dei pazienti

Il prezzo offerto per tali materassi è addirittura inferiore al prezzo corrisposto attualmente dal PTV in regime di proroga. Pertanto, in considerazione anche degli elementi sinergici nella gestione di tali superfici il prezzo e i materassi offerti appaiono congrui.

Roma, 17 marzo 2020

IL DEC
Alessandro Sili


IL RUP
Carla Cianciullo


DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UOC AFFARI GENERALI

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 18-3-2020 la deliberazione n. 260 del 17/03/2020 pdf conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del PTV www.ptvonline.it ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Massimo Guerrieri Wolf)

Visto, l'incaricato della pubblicazione

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine e di n. ____ allegati ed è conforme all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, _____

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Massimo Guerrieri Wolf)